

Pacient	
Věk [roky]	
Narození	
Váha [kg]	
Pohlaví	
Pozice EKG senzoru	
Report vyrobil [MobECG 1.7.8]	

Vysvětlivka	
Čas události	5. 1. 2018 4:37:34
Časové razítko	12996,00 s
Název souboru	2018-01-05_01.00.58.s2
Začátek měření	5. 1. 2018 1:00:58

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
 Measured with: MobECG 1.7.8; Sawy 1.0.2e [EB-8F-E5-2A-2F-BA]












[10,00mm/mV][25,00mm/s (40,00ms/mm)] [sampling frequency: 128,00Hz] rawdata

Pacient:

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s


0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
Measured with: MobECG 1.7.8; Sawy 1.0.2e [EB-8F-E5-2A-2F-BA]

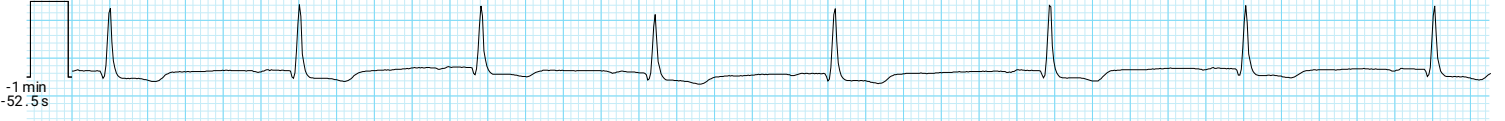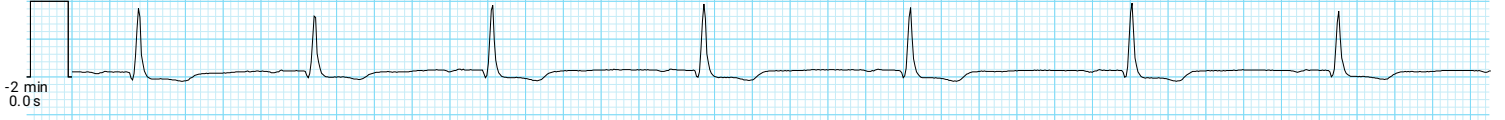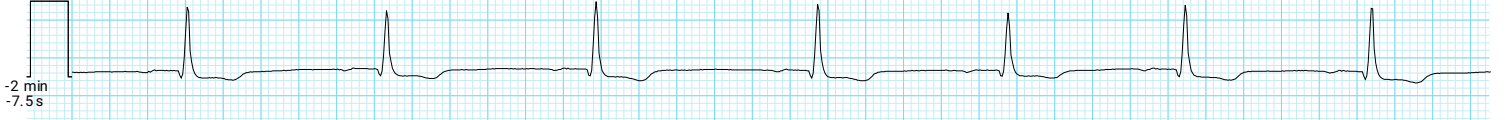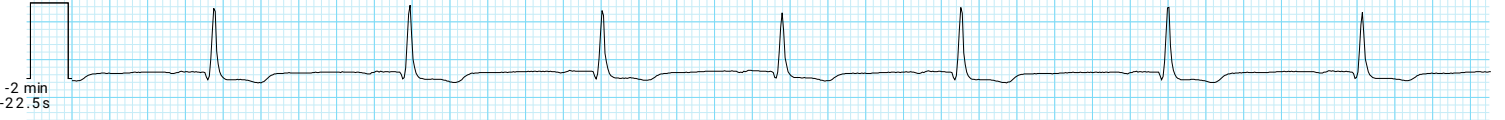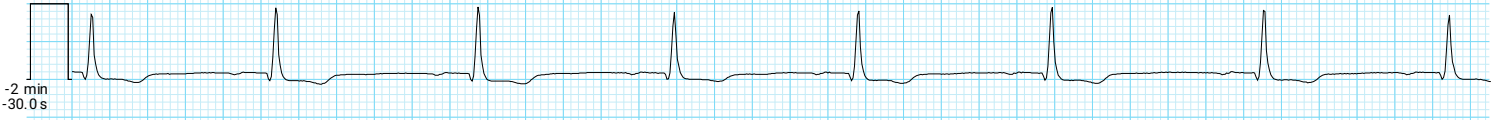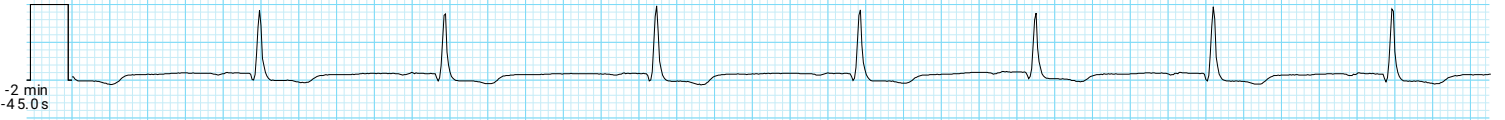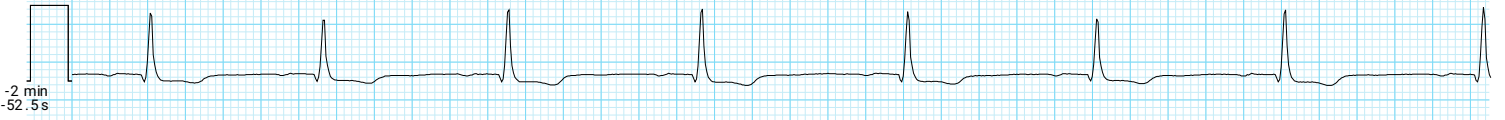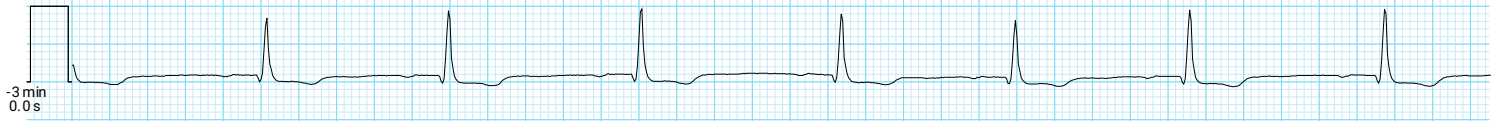

[10,00mm/mV][25,00mm/s (40,00ms/mm)] [sampling frequency: 128,00Hz] rawdata Patient:

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s


0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
Measured with: MobECG 1.7.8; Sawvy 1.0.2e [EB-8F-E5-2A-2F-BA]

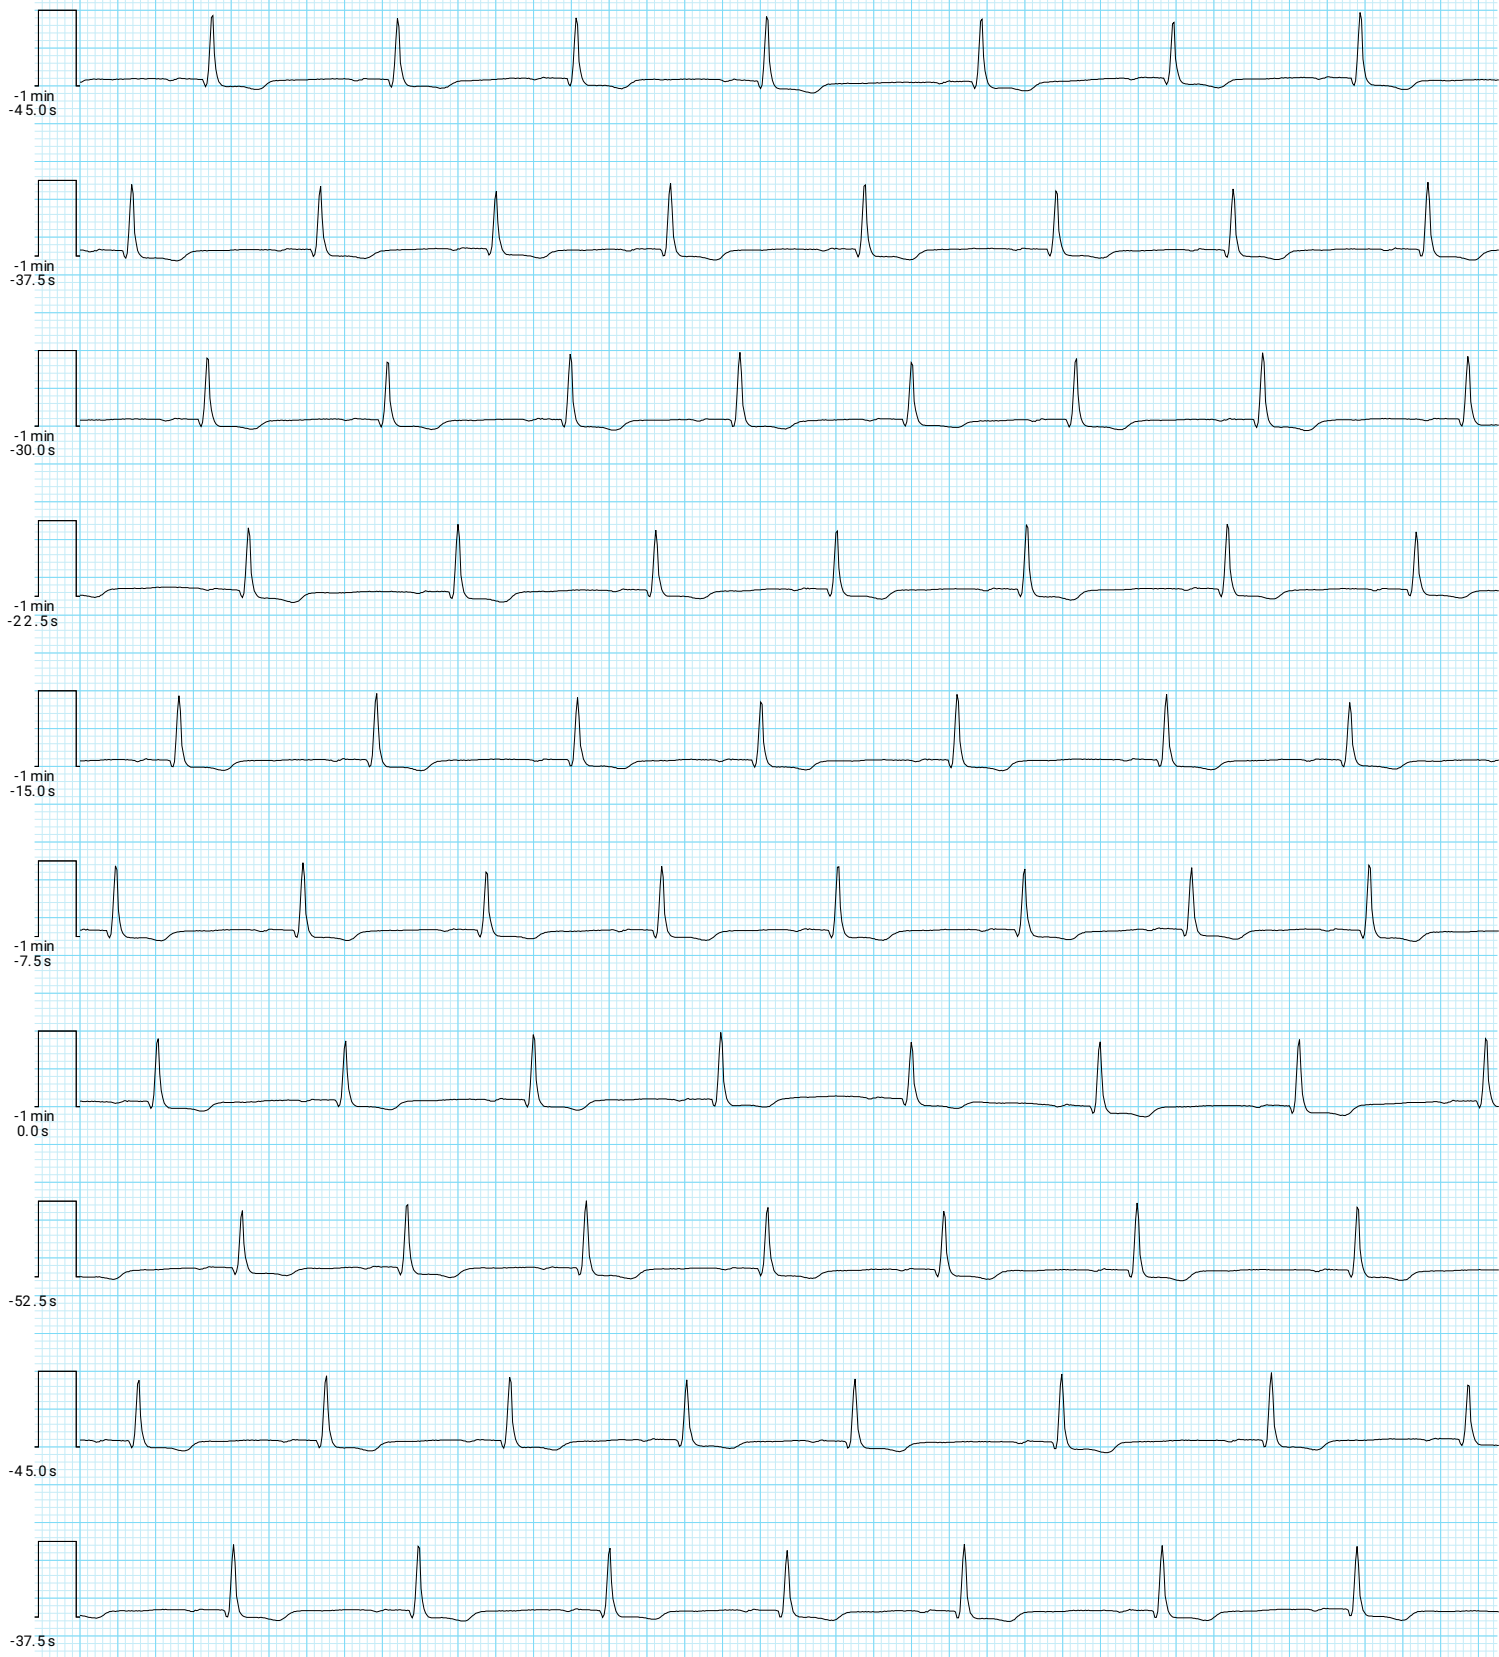









[10,00mm/mV][25,00mm/s (40,00ms/mm)] [sampling frequency: 128,00Hz] rawdata Patient:

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
Measured with: MobECG 1.7.8; Sawy 1.0.2e [EB-8F-E5-2A-2F-BA]

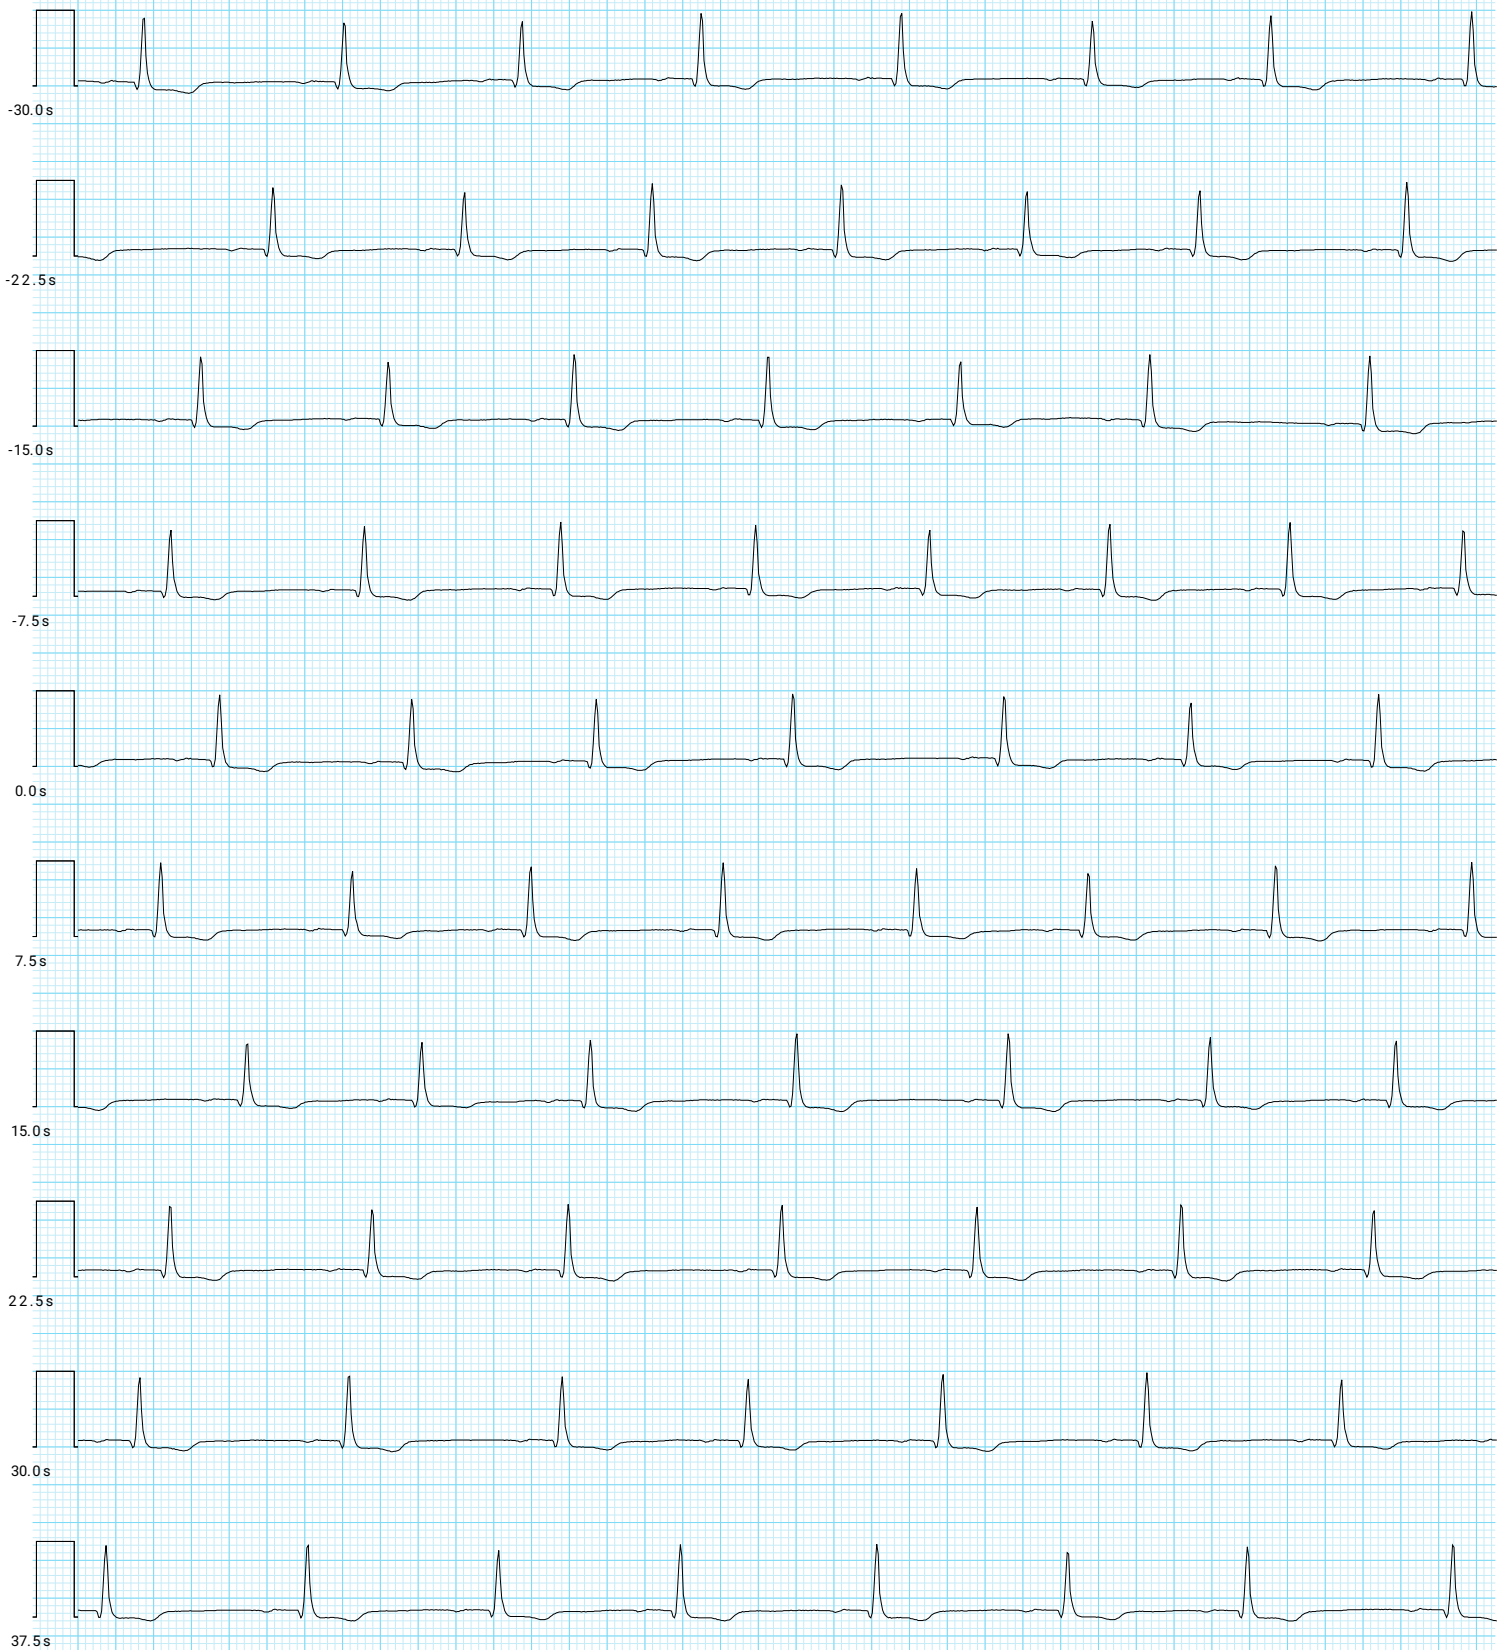

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s
Measured with: MobECG 1.7.8; Sawy 1.0.2e [EB-8F-E5-2A-2F-BA]













[10,00mm/mV][25,00mm/s (40,00ms/mm)] [sampling frequency: 128,00Hz] rawdata Patient:

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s

Measured with: MobECG 1.7.8; Sawy 1.0.2e [EB-8F-E5-2A-2F-BA]



[10,00mm/mV][25,00mm/s (40,00ms/mm)] [sampling frequency: 128,00Hz] rawdata

Pacient:

0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s

